


NICSS-EX3 システム系統図

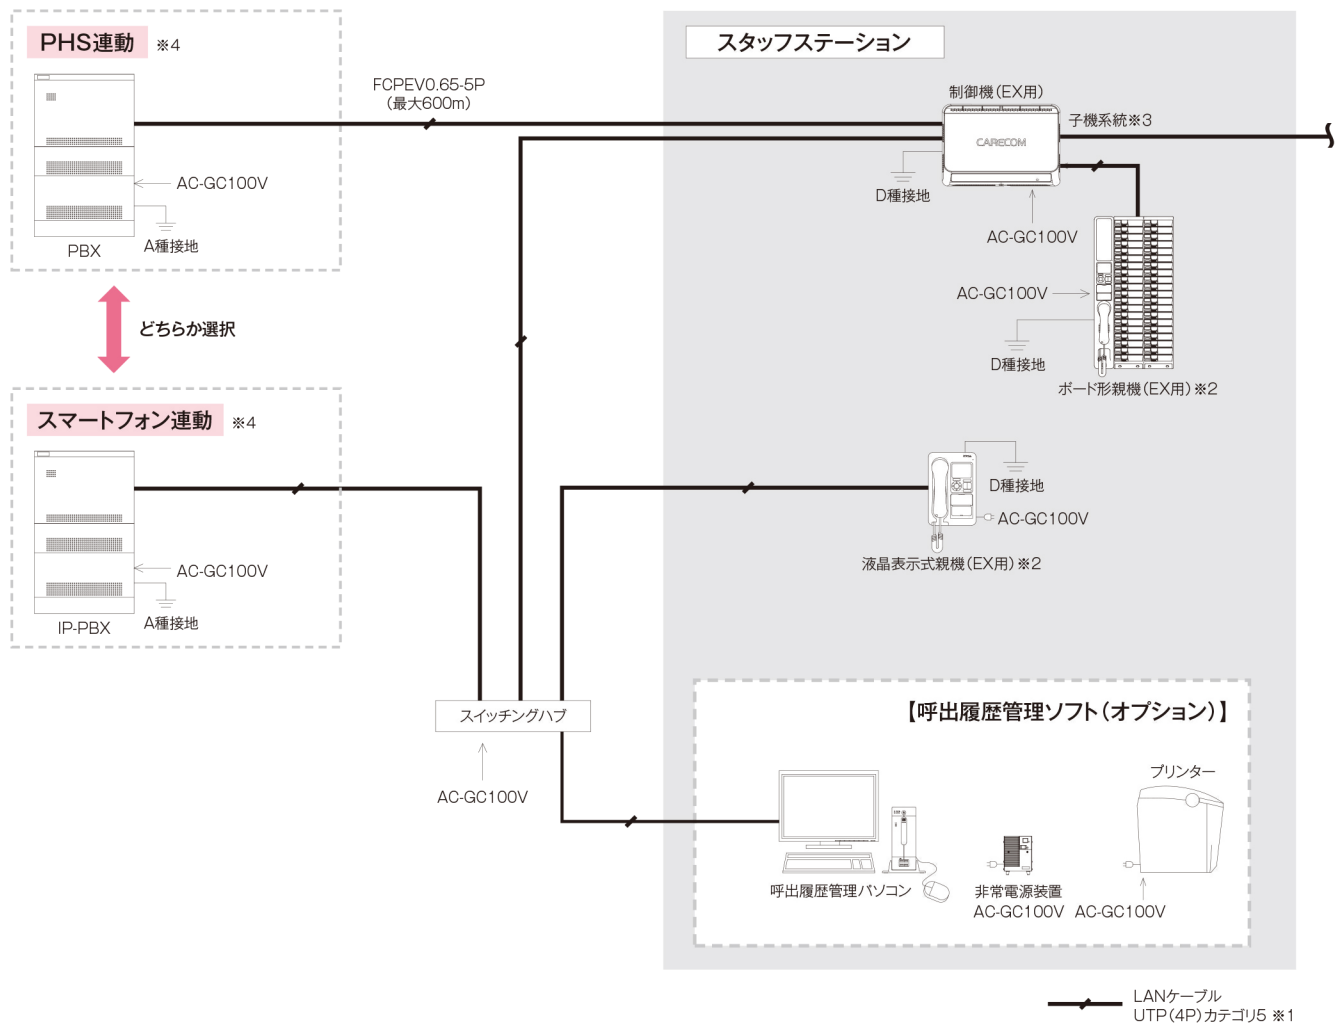

- ※1 ネットワークは100Base-TXを推奨。(最大100m)
- ※2 親機(EX用)は最大8台まで接続できます。1台の親機は制御機に直接接続し、2台目以降はスイッチングハブを使用して接続してください。
- ※3 制御機からベッドサイドまでの子機系統はNICSS-EX8と共通です。系統・機器構成はNICSS-EX8の系統図をご参照ください。
- ※4 基地局・アクセスポイントと端末が必要です。スマートフォン連動の場合、ネットワークの構成によりルーターが必要になります。詳細はPBXメーカーにお問い合わせください。

トイレ離座検知システム、エリア検知システムの系統・機器構成は個別に資料をご用意していますのでお問い合わせください。